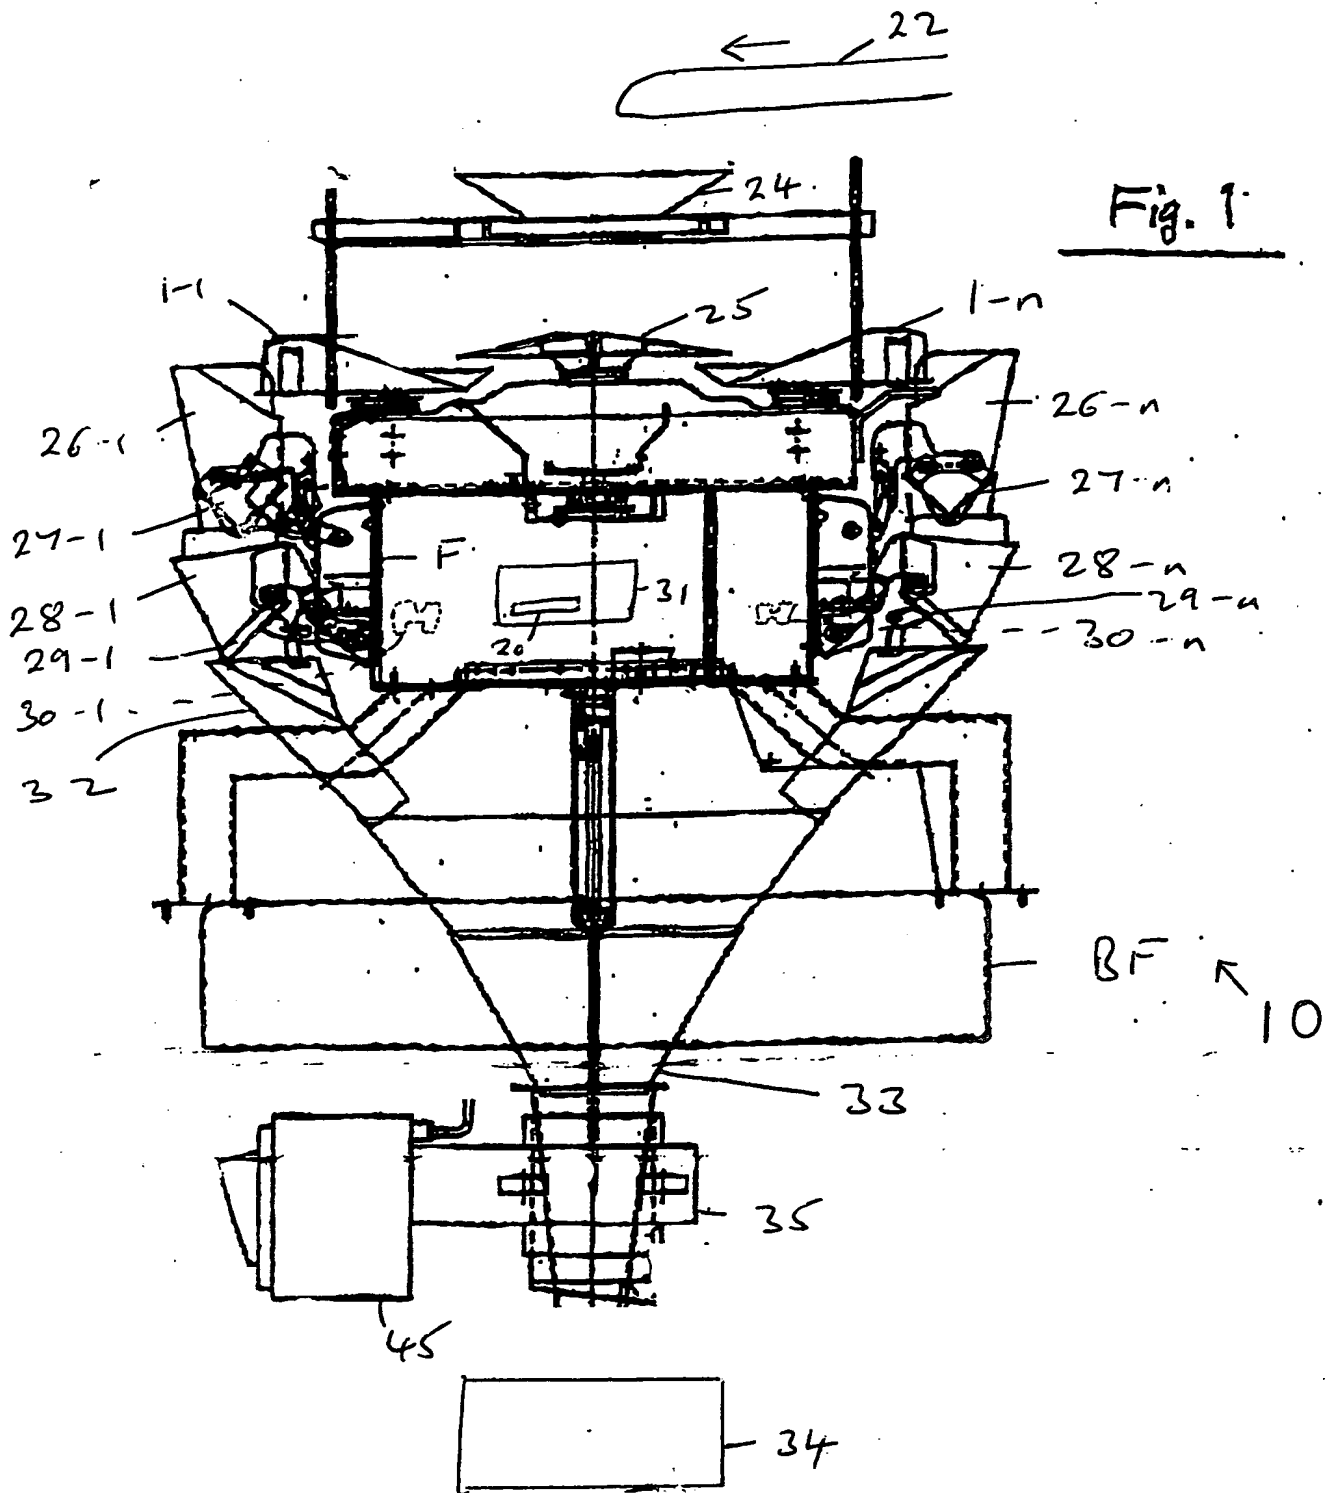


09864356-052501



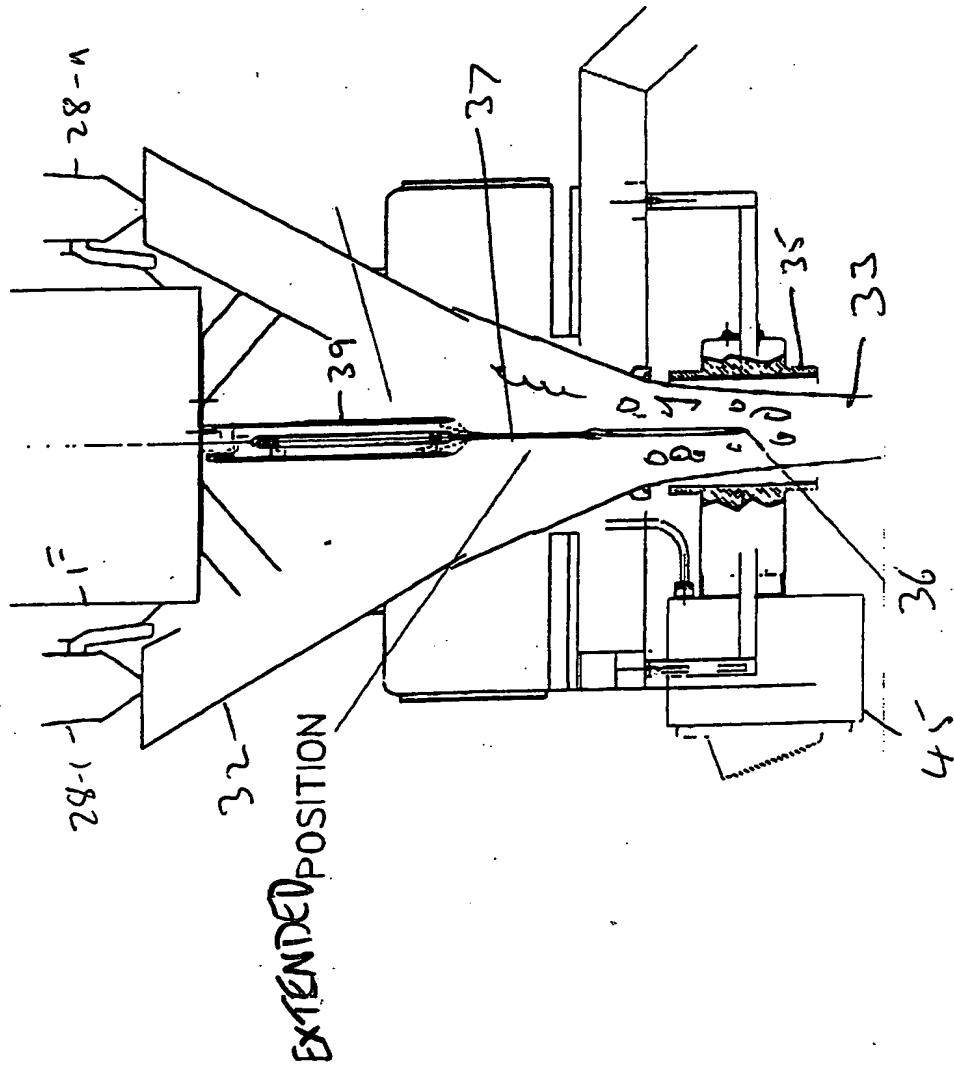


FIG. 2A

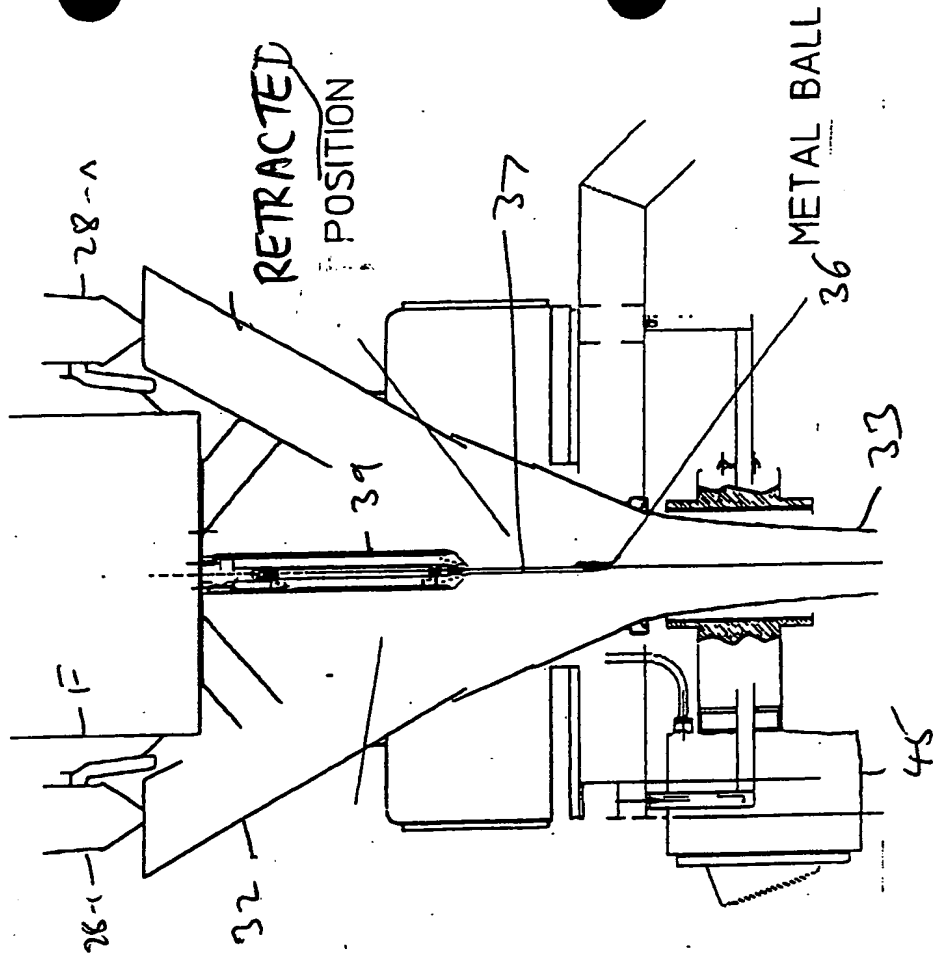


FIG. 2B

09864356 "052501
T05250" 9549860

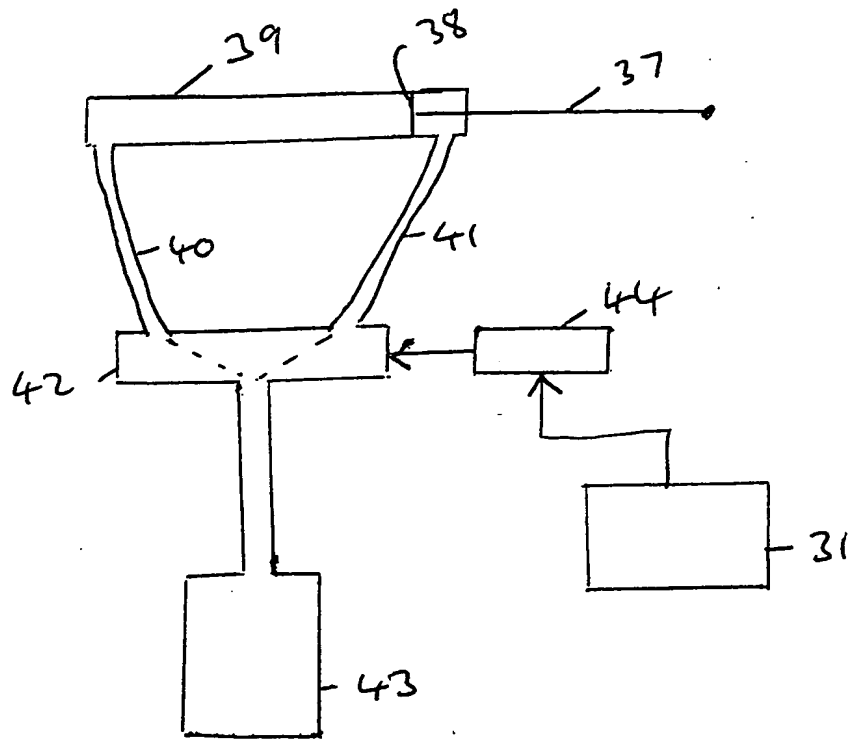


FIG 4

Set up parameters - 100

↓
Start - 102

↓
No → Discharge weighed articles? - 105

↓
Decrement cycle counter - 110

↓
To step 125 ← No Cycle counter = Preset Value - 115
↓ YES

Extend Probe - 120

↓
No → Metal Detected? - 125
↓ YES

135 - Stop Machine

Stop Machine - 130


↓
140 - Reset Sensitivity


↓
To step 105

↓
To step 102

FIG 5

09864356 052501

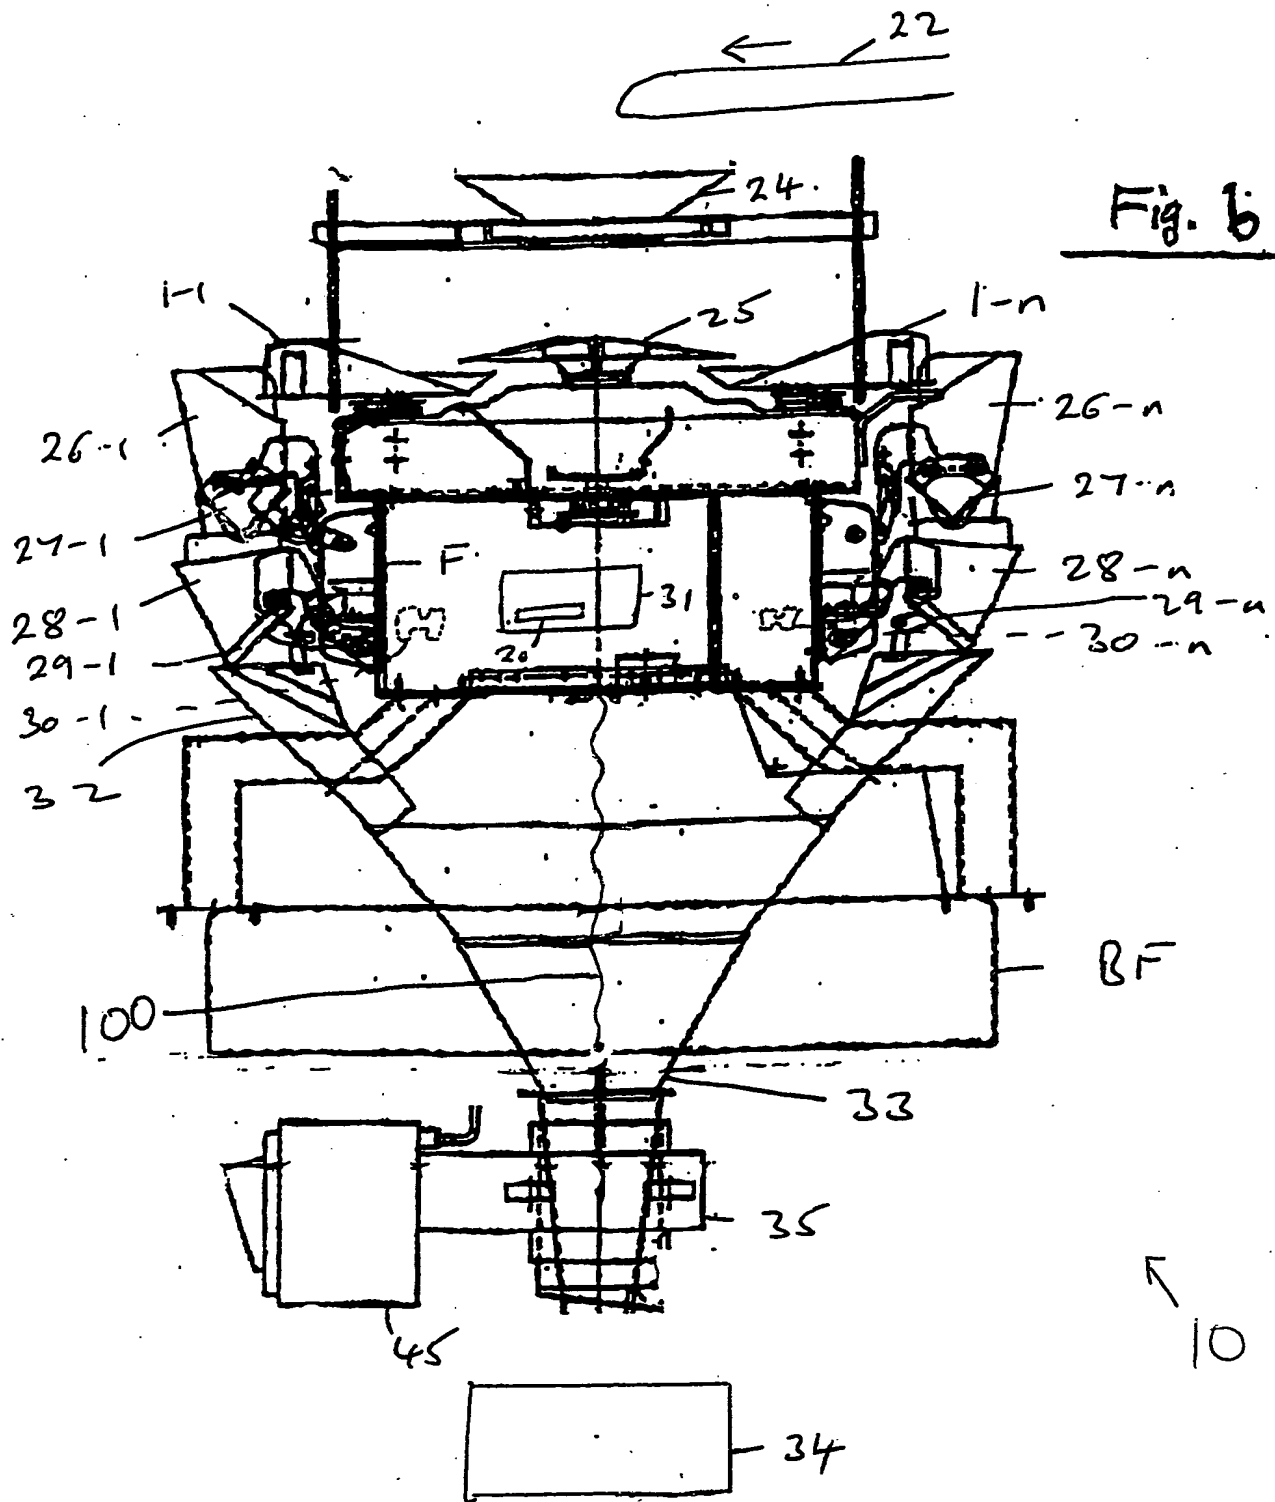

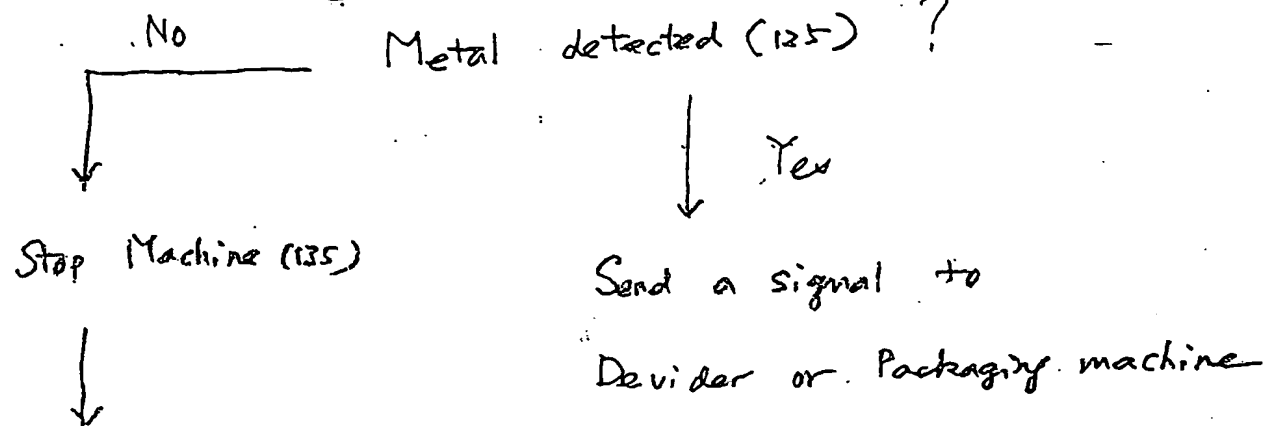

Reset Sensitivity (140)
↓
To step (102)

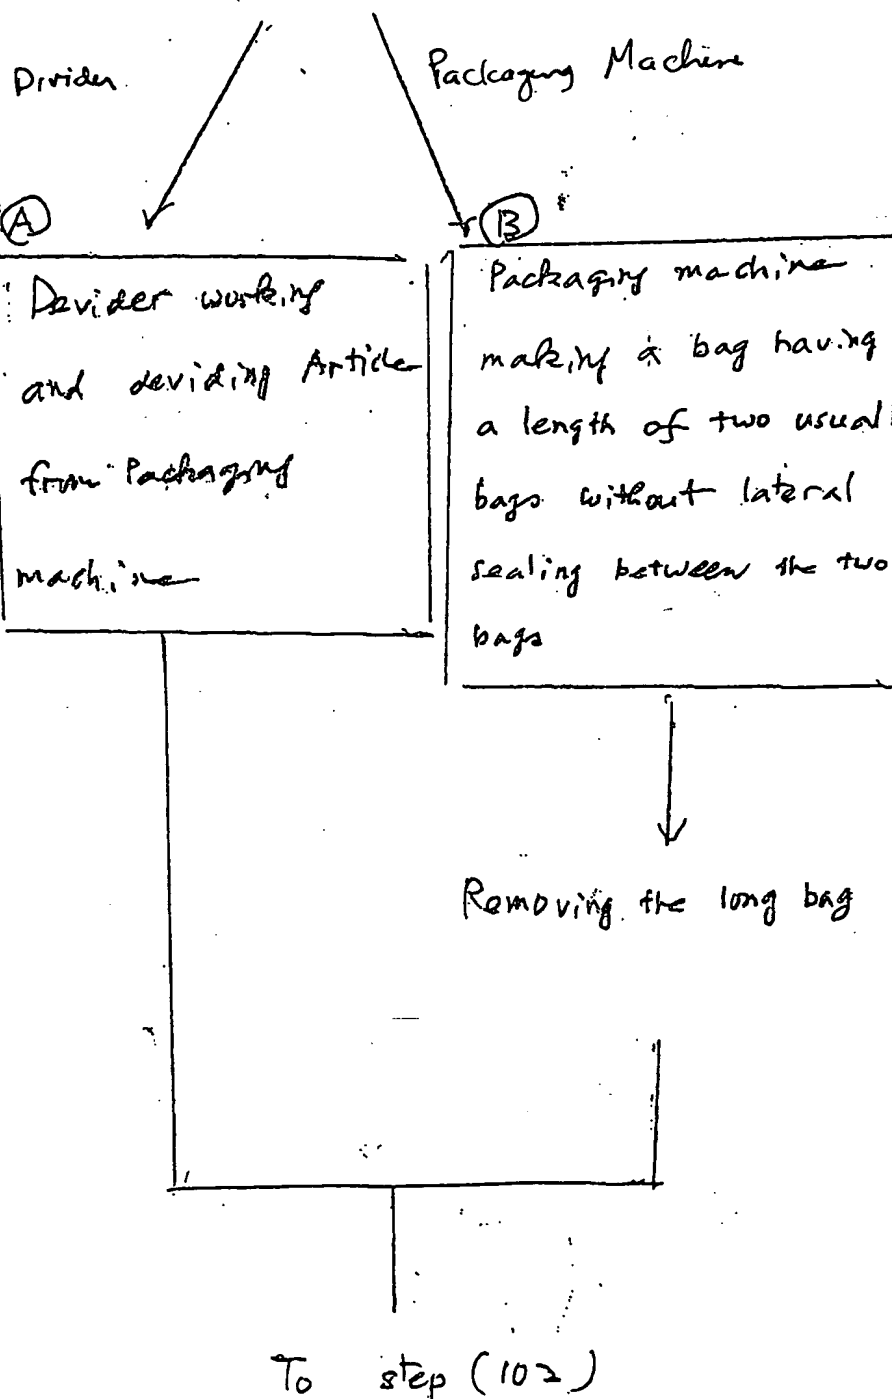


FIG. 7

